# オットーボック装具　取扱説明書 ②（製品篇）
# 4058　マニュ コンフォート ステーブル

**義肢装具士をはじめとする医療従事者の方々へ**

このたびは本製品をご採用いただきまして、誠にありがとうございます。本製品を安全にお取扱いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書①（基本篇）と取扱説明書②（製品篇）をよくお読みいただき、使用される方に装着方法、使用上の注意、お手入れ方法などを必ずご案内ください。
また取扱説明書①②は、必要な際にいつでも参照できるようにお手元に大切に保管してください。

**【適応・用途】**

『4058　マニュ コンフォート ステーブル』は手関節部分の麻痺や外傷、手術後などに対し、手関節の保護または固定する装具です。

| ⚠ 注意 | ● 適応については、必ず医師の診断を受けてください。 |
|---|---|

**【特徴】**

- ●手掌側のポケットに内蔵されている成型可能な立体樹脂ステーと背側の2 本のスパイラルステーにより手関節部のサポートを行います。
- ●手関節ストラップを周回させることで手関節の動きを抑制し、高い支持性が得られます。
- ●本体には伸縮性のある温度調整機能素材（PCM）を採用し、快適な装着感です。
- ●本製品の本体は筒型構造、折返しストラップを採用し、また面ファスナーの先がカンから抜け難い形状になっているため、片手での着脱が簡便です。

**【サイズの選び方】**

以下を参照し、サイズを選択してください。

（一箱 :1 個入り）

| 発注品番 | 右左/サイズ | | 適用範囲 手首周径（cm） |
|---|---|---|---|
| 4058=R-XS | 右 | XS-S | 13.0～16.0 |
| 4058=R-M | | M-L | 16.0～19.0 |
| 4058=R-XL | | XL-XXL | 19.0～23.0 |

| 発注品番 | 右左/サイズ | | 適用範囲 手首周径（cm） |
|---|---|---|---|
| 4058=L-XS | 左 | XS-S | 13.0～16.0 |
| 4058=L-S | | M-L | 16.0～19.0 |
| 4058=L-M | | XL-XXL | 19.0～23.0 |



・　計測値が 2 サイズにまたがる場合は、大きい方のサイズをお選びください。

【サイズの測り方】
イラストのように手首の周径を測ります。

**【調整方法と装着手順】**

| ⚠ 注意 | ● 本製品を初めて装着される際には、必ず医師、義肢装具士をはじめとした医療従事者による調整と装着手順の指導が必要となります。 |
|---|---|

装着前に取扱説明書①基本篇の【使用上の注意―必ずお読みください―】をよく読み、また、医療従事者による装着手順の指導に従って、正しく装着してください。（写真は右手の装着方法です。）

① 全ての面ファスナーを外し、筒型の本体に拇指、手首を通します。

② 遠位、近位 2 ヵ所の面ファスナーを留めます。

③ 手関節のストラップは周回させて留めます。

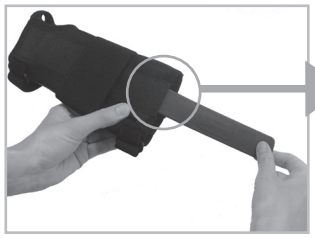

本体からの取外しが可能です。

④ 手掌側のポケットに内蔵されているプラスチックステーは、あらかじめ手関節に合せた形状をしていますが、75 ～ 80℃のお湯により軟化させ、装着者に合せて更に微調整できます。

⑤ 左の写真の通り、正しく装着できているかを確認し、必要に応じて、ズレ、ゆるみ、締め付けすぎなどがないように装着状態を調整してください。

**【お手入れ方法と注意事項】**

| ⚠ 注意 | ● お手入れをされる場合には、取扱説明書 ①【お手入れ方法と注意事項】を必ずご覧ください。 |
|---|---|

・プラスチックステーはポケットに内蔵されていますので、本体から取外すことができます。お手入れの際には本体から取外し、布で水拭きしてください。

**【品質表示】**

本体：ナイロン、ポリウレタン
プラスチックステー：ナイロン
スパイラルステー：鉄

**お問合わせ先**

**掲載内容の無断使用禁止**

掲載されている内容、文章、画像については、無断で使用もしくは転載することを禁止します。

**輸入販売元**
**オットーボック・ジャパン株式会社** www.ottobock.co.jp
〒108-0023 東京都港区芝浦4-4-44 横河ビル8F　TEL:03-3798-2111(代表) FAX:03-3798-2112

O-IFU-T-4058-201209